
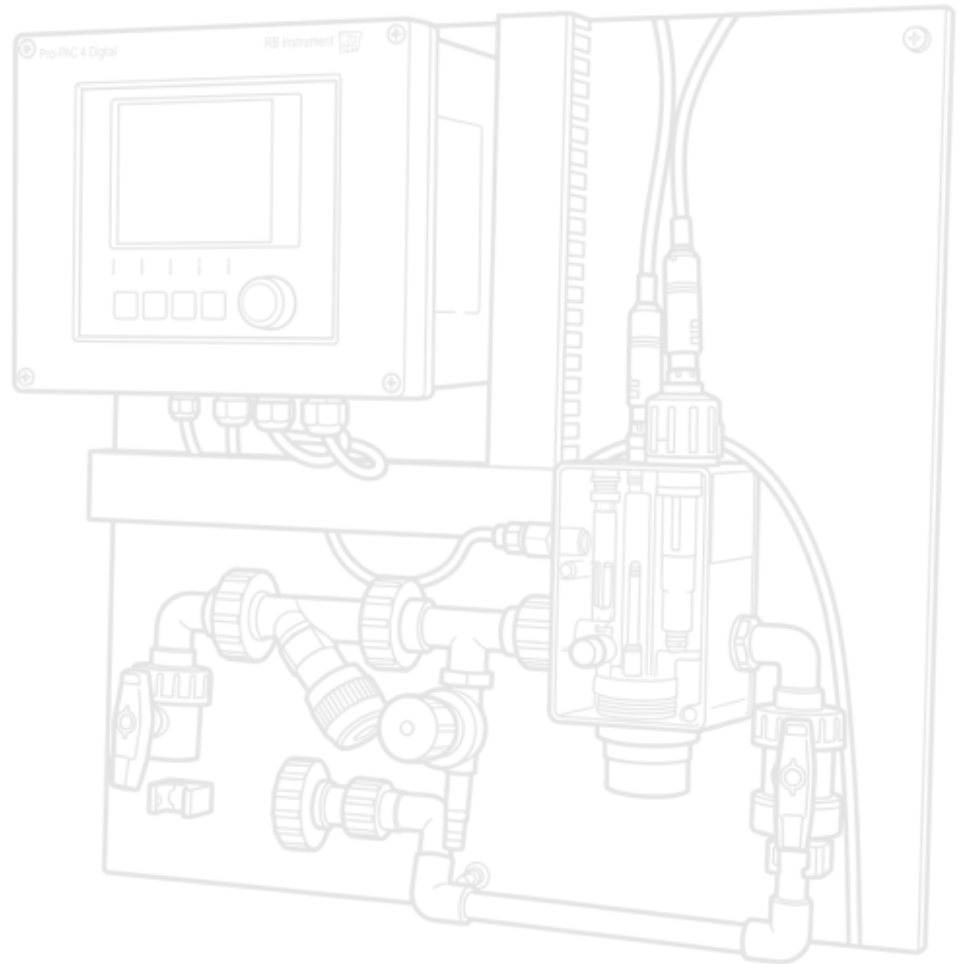


TECHNOLOGIE DE MESURE ET DE RÉGULATION DE LA CONDUCTIVITÉ ET DU PH DOCUMENTATION

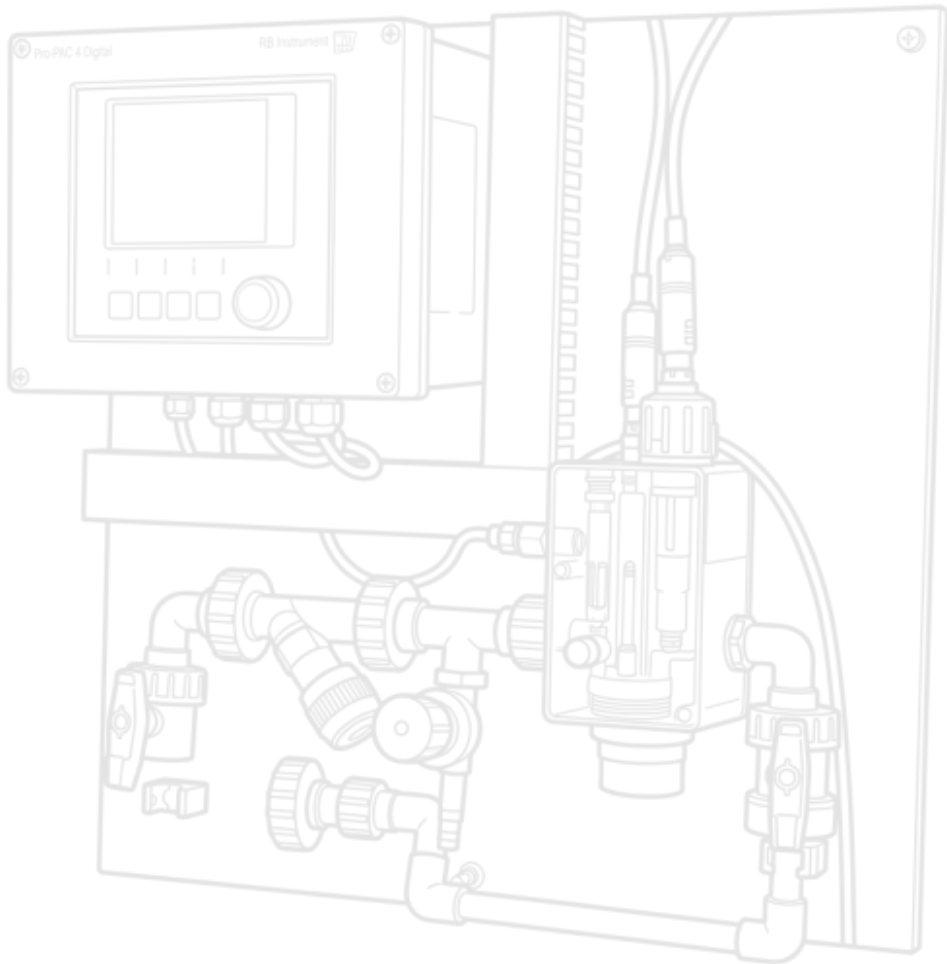

POOLPAC 2 DIGITAL

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs de température et de pH sont également utilisées pour la compensation de la mesure du chlore libre. Équipé en standard d'un journal de bord interne qui enregistre toutes les modifications et les calibrations.

L'appareil est entièrement câblé et testé..
Cette armature est équipée d'un filtre à impuretés, de 2 robinets à boisseau sphérique et d'une vanne de soufflage d'eau de mesure, en amont de l'armature de débit. Ainsi, l'étalonnage et l'entretien sont faciles à réaliser.

Capteur de chlor digital Type	OCCS51D
Electrode pH combinée digitale Type	OCPS31D
Plages de mesure	0 - 20,0 mg CL2, 1 - 12 pH, 0 - 80°C
Display	0 - 20,0 mg CL2, 0 - 14 pH, 0 - 100°C
Régulation	P, PI, PID ou PD Longueur d'impulsion ou fréquence d'impulsion pour pH et CL2, contact d'alarme pour p. ex.
Protection	IP66/67, Etanchéité et résistance à la corrosion.
Sorties	2 x 0/4 - 20 mA uet2 x digital (librement programmables)
Alimentation électrique	230 V, 50/60 Hz
Installation	Montage mural, 3x Patte de fixation
Dimensions	495x495mm

